


瓶缶兼用ガス圧計 KN-Y10 取扱方法

- 1 固定レバーをハンドル方向に押し上げると、ハンドルは上下に移動します。まず、ハンドルを被測物より高くセットしておきます。測定しようとする缶またはビンを挟むようにしてハンドルのA部を強く下方に押しすと、ハンドルは缶またはビンの高さに応じて自動的に止まります。（ガイドバーに油などが附着しますと、固定レバーがすべることがありますので、このような時は紙で拭いてください）
- 2 ハンドルが止まった状態で手をはなしてもハンドルは静止していますから、この状態で圧力計の指示を読み取ってください。（テストを振る場合は、ハンドルに親指を当ててガイドバーを握って振ってください）
- 3 ハンドルを下方に押し際は固定レバーには手を触れないでください。
- 4 測定後は固定レバーを押す（ハンドルと共ににぎる）ことにより、簡単にハンドルを移動させることができます。
- 5 圧力計を検査する際には後部にあるバルブを90°回転させて圧力計を左へまわして取りはずしてください。なお、バルブはネジ込み式のため無理な締込みは厳禁です。
- 6 使用後はゲージ以外は水洗いし、よく水気を拭き取ってから保管してください。



各 部 名 称

別 売 部 品

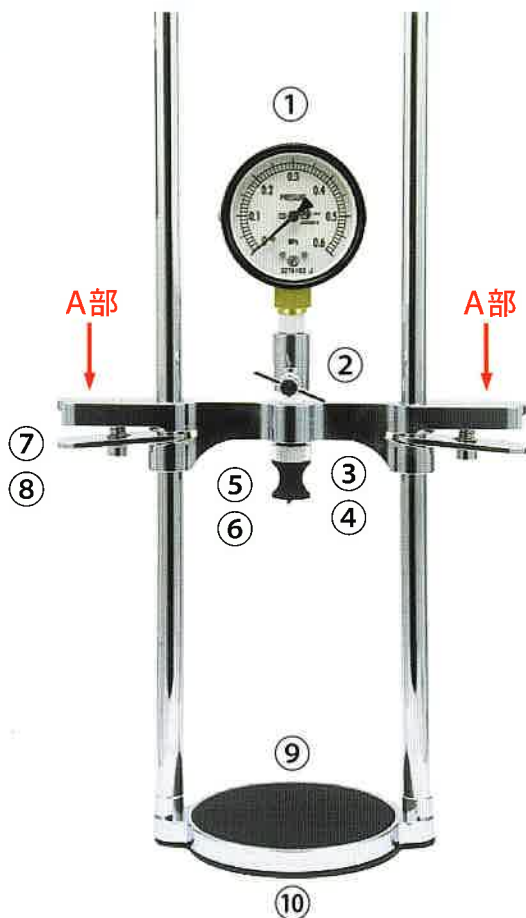

- ① 圧力ゲージ
- ② エアー抜き
- ③ ローレットネジ
- ④ ローレットネジ用ゴムパッキン(リング) (4個入)
- ⑤ ツツミ型ゴムパッキン (3個入)
- ⑥ 針 (3本入)
- ⑦ 固定レバー用スプリング (4本入)
- ⑧ 固定レバー板 (2枚入)
- ⑨ 丸底ゴム板
- ⑩ 耳付丸底ゴム板

※ 上記、各部部品の販売を行っております

 株式会社 長嶋製作所

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-14-10

TEL. 03-3811-4770 FAX.03-3815-7990

Email:info@nagashimass.co.jp